

米国AMI社製

# タブレットアプリ型PVTモニター

- 行動科学の標準測定における  
ゴールデンスタANDARD
- いつでもどこでも簡単に測定できる  
タブレット型
- ミリ秒単位で表示する反応・反復時間  
測定

## Psychomotorの衰えの指示に お役立ていただけます。

- ◆ タブレットの機種選定及びプログラムインストール作業は弊社で行います。
- ◆ タブレットにインストールするプログラムは別紙カタログ表示の機能のみ確保しますが、他の機能は製造会社製品の性能に準じます。
- ◆ タブレットの使用限界はタブレット製造会社の性能に準じます。



米国AMI社アジア総代理店  
サニタ商事株式会社

2021年3月


〒160-0011 東京都新宿区若葉 I - 22 ロイヤル若葉  
TEL: 03-3359-4341 FAX: 03-3359-4344

210303


米国AMI社製

# タブレットアプリ型PVTモニター

3分、5分、10分PVT測定  
測定結果をパソコンにメールで送信

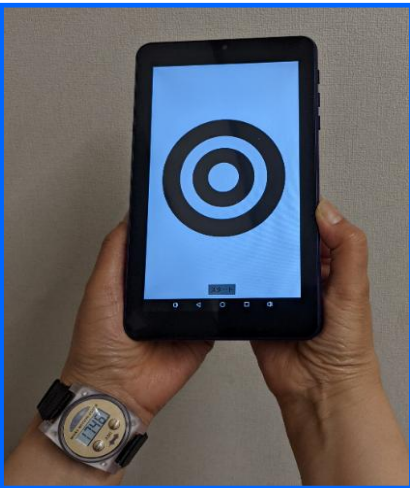

反応時間 : PVTデータ分析

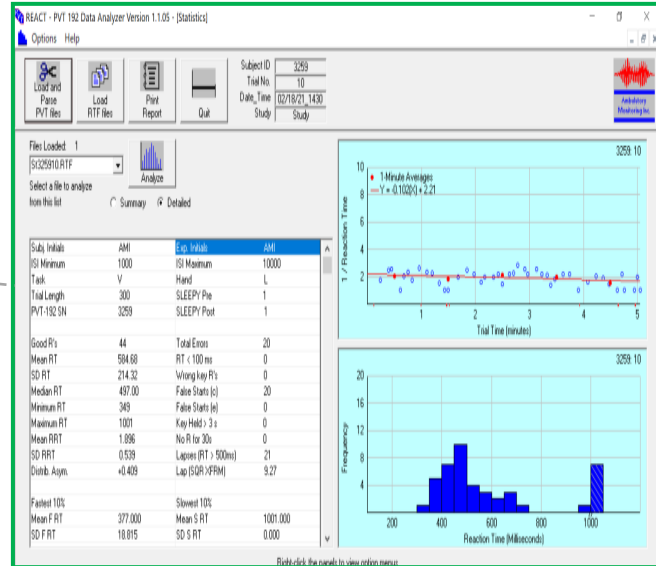

## 「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」

このたび厚生労働省より公表された標記マニュアルに、米国AMI社製マイクロモーションロガー時計型アクチグラフ及びPVT-192型モニターについて記載されていますので、下記URLよりダウンロードして、是非ご照覧下さい。

## 「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」

<https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000677260.pdf>

第9回医師の働き方改革の推進に関する検討会

(上記資料はこの検討会の一部資料です↓)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_13842.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13842.html)



米国AMI社アジア総代理店  
サニタ商事株式会社

〒160-0011 東京都新宿区若葉 I - 22 ロール若葉  
TEL: 03-3359-4341 FAX: 03-3359-4344

2021年3月

201506\_EARTH\_TC\_SYA-2